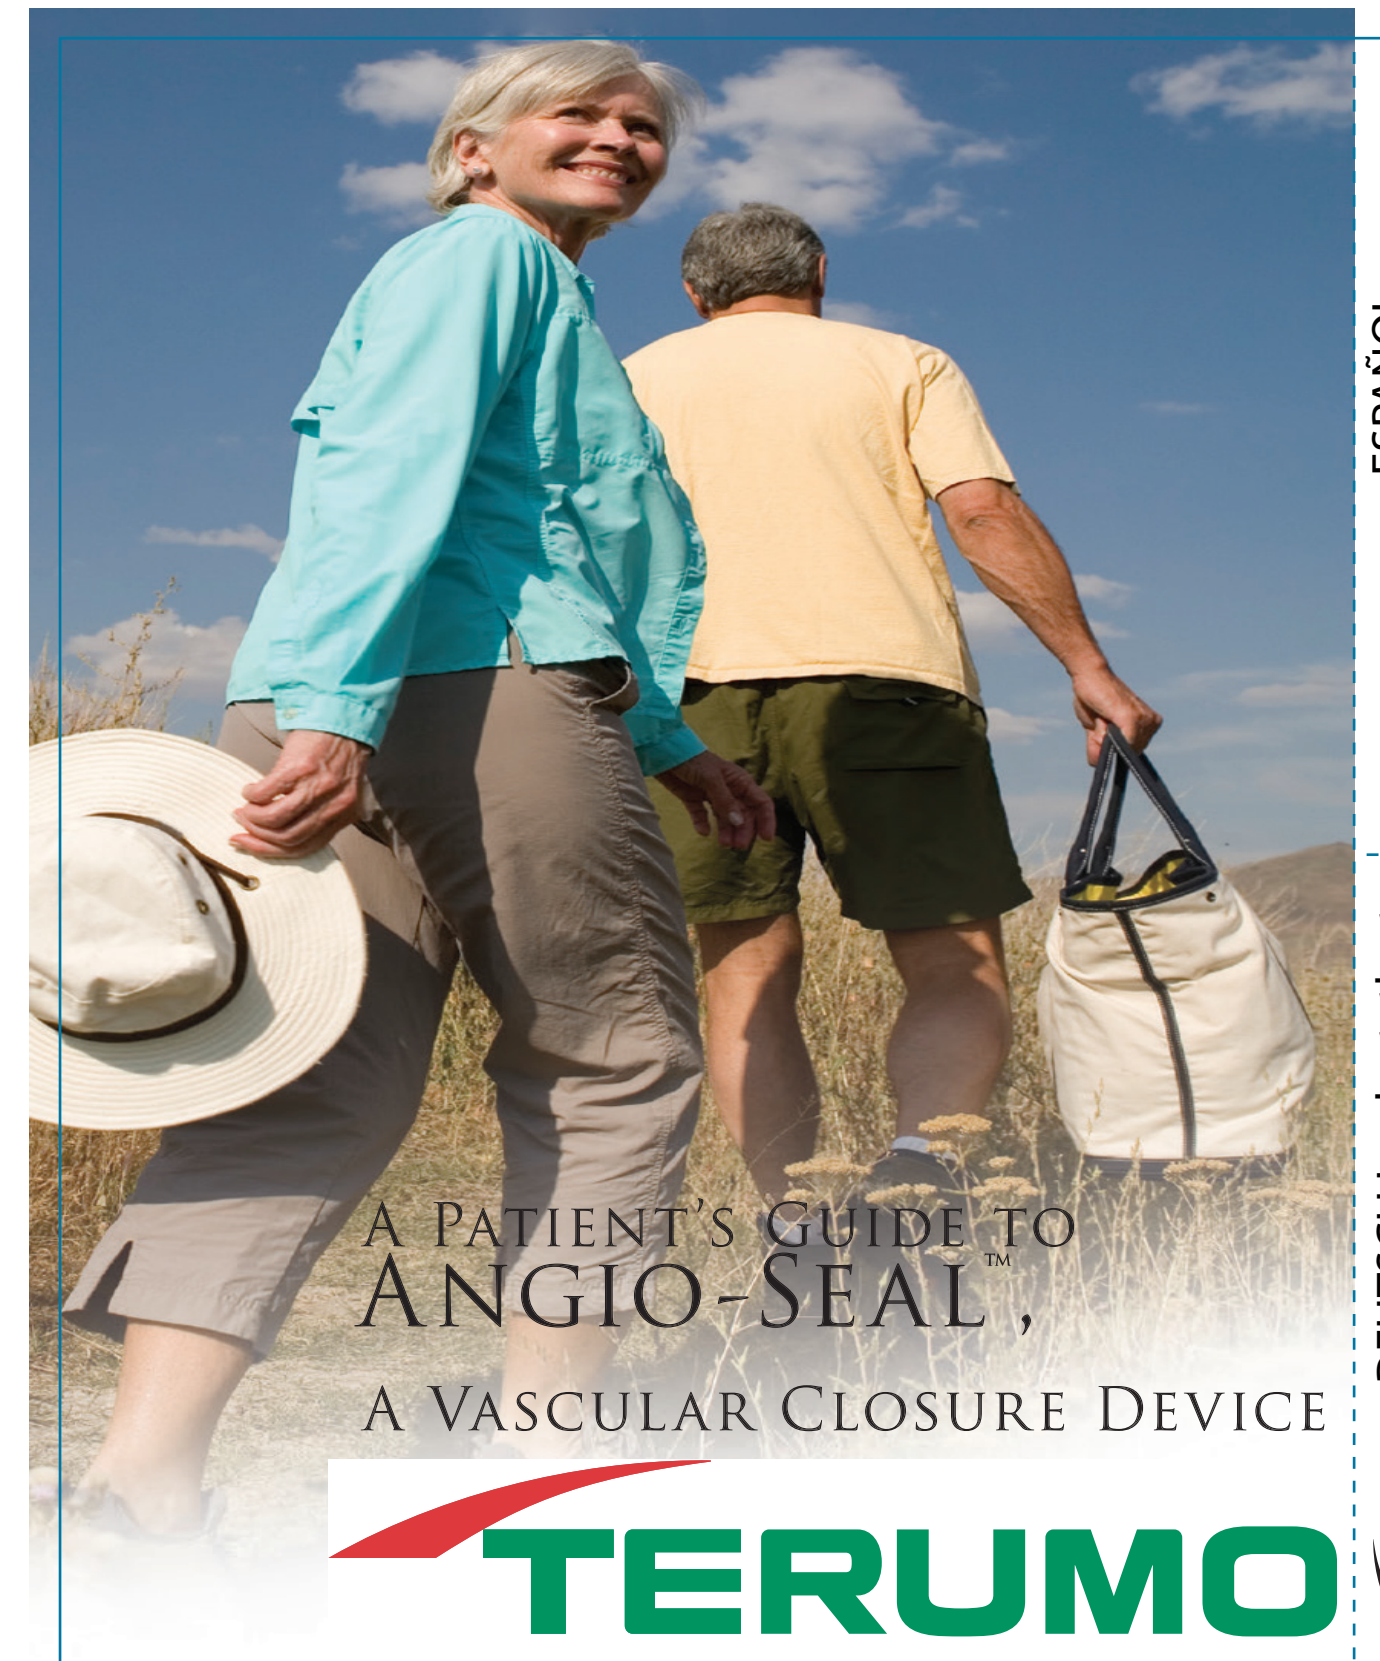

A PATIENT'S GUIDE TO
ANGIO-SEAL™,
A VASCULAR CLOSURE DEVICE

TERUMO

ESPAÑOL Tarjeta de Implante
TERUMO
Dispositivo de cierre vascular Angio-Seal™
Tipo de dispositivo: Dispositivo de cierre vascular
Angio-Seal™ colocado en la arteria femoral: □ Derecha □ Izquierda
Materiales absorbidos
Conserve esta tarjeta durante los próximos 90 días
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Colocar adhesivo

ČEŠTINA Karta implantátu
TERUMO
Prostředek pro uzavírání cév Angio-Seal™
Typ prostředku: Prostředek pro uzavírání cév
Angio-Seal™ umístěný ve femorální tepně: □ pravé □ levé
Absorbované materiály
Noste prosím tuto kartu u sebe po dobu následujících 90 dní
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
„Place Sticker" (Umístit štítek)

EESTI Implantaadi kaart
TERUMO
Vaskulaarne sulgemisseade Angio-Seal™
Seadme tüüp: vaskulaarne sulgemisseade
Reiearterisse paigaldatud Angio-Seal™: □ parem □ vasak
Absorbeeruvad materjalid
Palun kandke seda kaarti järgmised 90 päeva endaga kaasas
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Kleebise koht

LATVISKI Implantu lietotāja karte
TERUMO
Angio-Seal™ asinsvadu slēgšanas ierīce
Iekārtas veids: Asinsvadu slēgšanas ierīce
Angio-Seal™ ievieto augšstilba artērijā: □ pa labi □ pa kreisi
Absorbētie materiāli
Saglabājiet šo karti turpmākās 90 dienas
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Pielīmējiet uzlīmi

NORSK Implantatkort
TERUMO
Angio-Seal™ vaskulært lukkesystem
Enhetstype: Vaskulært lukkesystem
Angio-Seal™ plassert i lårarterien: □ Høyre □ Venstre
Absorberte materialer
Vennligst ha dette kortet med deg de neste 90 dagene
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Klistremerke her

РУССКИЙ Карта имплантата
TERUMO
Устройство для закрытия сосудов Angio-Seal™
Тип устройства: Устройство для закрытия сосудов
Устройство Angio-Seal™ размещено в бедренной артерии: □ справа □ слева
Абсорбированные материалы
Эту карту следует хранить при себе в течение следующих 90 дней
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Поместите наклейку

TÜRKÇE Implant Kartı
TERUMO
Angio-Seal™ Vasküler Kapatma Cihazı
Cihaz Tipi: Vasküler Kapatma Cihazı
Angio-Seal™'in yerleştirildiği femoral arter: □ Sağ □ Sol
Emilen materyaller
Lütfen bu kartı 90 gün boyunca yanınızda bulundurun
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Çıkartmayı Yapıştırın

한국 임이식물 카드
TERUMO
Angio-Seal™ 혈관 봉합 장치
장치 유형: 혈관 봉합 장치
Angio-Seal™ 장치의 대퇴 동맥 배치: □ 오른쪽 □ 왼쪽
흡수 물질
이 카드를 앞으로 90 일 동안 보관해 주십시오.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
스티커 부착

ROMÂNĂ Card de implant
TERUMO
Dispozitiv de închidere vasculară Angio-Seal™
Tipul dispozitivului: Dispozitiv de închidere vasculară
Angio-Seal™ plasat în artera femurală: □ Dreapta □ Stânga
Materiale absorbite
Păstrați acest card asupra dumneavoastră pentru următoarele 90 de zile.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Plasați autocolantul

УКРАЇНСЬКА Картка з інформацією про пацієнта з імплантатом
TERUMO
Пристрій для закриття місця пункції судини Angio-Seal™
Тип пристрою: пристрій для закриття місця пункції судини
Angio-Seal™ встановлено в стегнову артерію: □ Права нога □ Ліва нога
Абсорбовані матеріали
Носіть цю картку з собою протягом наступних 90 днів.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Місце для етикетки

DEUTSCH Implantatkarte
TERUMO
Angio-Seal™ Gefäßverschlusssystem
Produkttyp: Gefäßverschlusssystem
Angio-Seal™ in der Oberschenkelarterie: □ Rechts □ Links
Absorbierte Materialien
Bitte führen Sie diese Karte die nächsten 90 Tage mit sich
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Hier Etikett anbringen

ITALIANO Scheda Impianto
TERUMO
Sistema di chiusura vascolare Angio-Seal™
Tipo dispositivo: Dispositivo di chiusura vascolare
Angio-Seal™ posizionato nell'arteria femorale: □ destra □ sinistra
Materiali assorbiti
La preghiamo di conservare questa scheda per i prossimi 90 giorni
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Applicare etichetta

ΕΛΛΗΝΙΚΑ κάρτα εμφυτεύματος
TERUMO
Σύστημα σύγκλεισης αγγείων Angio-Seal™
Τύπος συσκευής: Συσκευή σύγκλεισης αγγείων
Angio-Seal™ τοποθετημένο στη μηριαία αρτηρία: □ Δεξιά □ Αριστερά
Απορροφήσιμα υλικά
Να έχετε αυτήν την κάρτα μαζί σας για τις επόμενες 90 ημέρες
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Τοποθέτηση αυτοκόλλητου

MAGYAR Implantációs Kártya
TERUMO
Angio-Seal™ érelzáró rendszer
Eszköztípus: Érelzáró eszköz
Angio-Seal™ eszköz a combartériába helyezve: □ Jobb □ Bal
Felszívódó anyagok
Ezt a kártyát a következő 90 napban tartsa magánál.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Matrica helye

NEDERLANDS Implantaatkaart
TERUMO
Angio-Seal™ Vasculair sluitsysteem
Type hulpmiddel: Vasculair sluitsysteem
Angio-Seal™ in femorale arterie: □ Rechts □ Links
Geabsorbeerde materialen
Draag deze kaart de komende 90 dagen bij u
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Sticker aanbrengen

PORTUGUESE Ficha de Implante
TERUMO
Dispositivo de oclusão vascular Angio-Seal™
Tipo de dispositivo: Dispositivo de oclusão vascular
Angio-Seal™ colocado na artéria femoral: □ Direita □ Esquerda
Materiais absorvidos
Guarde este cartão consigo durante os próximos 90 dias.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Colocar autocolante

SVENSKA Implantatkort
TERUMO
Angio-Seal™ kärlförslutningsenhet
Enhetstyp: Kärlförslutningsenhet
Angio-Seal™ placerad i lårbensartär: □ höger □ vänster
Absorberade material
Ha kortet med dig under de kommande 90 dagarna.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Placera klistermärke

日本のインプラントカード
TERUMO
Angio-Seal™ 血管閉鎖デバイス
デバイスタイプ：血管閉鎖デバイス
大腿動脈に Angio-Seal™ を配置：□ 右 □ 左
吸収物質
このカードは 90 日間お手元にお持ちください。
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
ステッカー貼付位置

HRVATSKI Kartica s informacijama o implantaciji
TERUMO
Uređaj za zatvaranje krvnih žila Angio-Seal™
Vrsta uređaja: uređaj za zatvaranje krvnih žila
Angio-Seal™ postavljen u femoralnu arteriju: □ desno □ lijevo
Apsorbirani materijali
Nosite ovu karticu sa sobom sljedećih 90 dana
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Postavite naljepnicu

SRPSKI Kartica implantata
TERUMO
Angio-Seal™ sredstvo za zatvaranje mesta vaskularnog pristupa
Tip sredstva: Sredstvo za zatvaranje mesta vaskularnog pristupa
Sredstvo Angio-Seal™ plasirano u femoralnu arteriju: □ Desno □ Levo
Apsorbovani materijali
Nosite ovu karticu sa sobom u narednih 90 dana
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Nalepite nalepnicu

بطاقة الزرع الدولية
TERUMO
جهاز إغلاق الأوعية الدموية Angio-Seal ™
نوع الجهاز: جهاز إغلاق الأوعية الدموية
توضع جهاز Angio-Seal ™ في الشريان الفخذي: □ الأيمن □ الأيسر
المواد الممتصة
يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة معك خلال التسعين يومًا القادمة
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
موضع الملصق

ENGLISH Implant Card
TERUMO
Angio-Seal™ Vascular Closure Device
Device Type: Vascular Closure Device
Angio-Seal™ placed in femoral artery: □ Right □ Left
Absorbed materials
Please keep this card with you for the next 90 days
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Place Sticker

FRANÇAIS Carte d'implant
TERUMO
Dispositif de fermeture vasculaire Angio-Seal™
Type de dispositif : Dispositif de fermeture vasculaire
Angio-Seal™ placé dans l'artère fémorale : □ Droite □ Gauche
Matériel absorbé
Veuillez conserver cette carte sur vous pendant les 90 prochains jours.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Placer l'autocollant

DANSK Implantatkort
TERUMO
Angio-Seal™ Vascular Closure Device
Udstyrstype: Udstyr til lukning af blodkar
Angio-Seal™ placeret i arteria femoralis: □ Højre □ Venstre
Absorberede materialer
Sørg for at have dette kort på dig de næste 90 dage
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Placer mærkaten

SUOMI Implanttikortti
TERUMO
Angio-Seal™-verisuonensulkulaite
Laitetyyppi: Verisuonensulkulaite
Angio-Seal™ on asetettu reisivaltimoon: □ Oikea □ Vasen
Absorboituvat materiaalit
Pidä tämä kortti mukanasi seuraavien 90 päivän ajan.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Paikka tarralle

LIETUVIŠKAS Implantų kortelė
TERUMO
„Angio-Seal™" kraujagyslių uždarymo priemonė
Prietaiso tipas: Kraujagyslių uždarymo įtaisas
„Angio-Seal™" įstatomas į šlaunies arteriją: □ dešiniają □ kairiąją
Absorbuojamos medžiagos
Atsineškite 90 dienų šią kortelę nešiokitės su savimi
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Užklijuokite lipduką

POLSKI Karta Implantu
TERUMO
Urządzenie do zamykania naczyń krwionośnych Angio-Seal™
Typ urządzenia: Urządzenie do zamykania naczyń
Angio-Seal™ umieszczane w tętnicy udowej: □ Prawa strona □ Lewa strona
Materiały wchłaniane
Proszę zachować tę kartę przy sobie przez następne 90 dni.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Umieść naklejkę

SLOVENČINA Karta implantátu
TERUMO
Pomôcka na uzavretie ciev Angio-Seal™
Typ pomôcky: Pomôcka na uzavretie ciev
Pomôcka Angio-Seal™ vo femorálnej artérii: □ Pravá □ Ľavá
Absorbované materiály
Kartu noste so sebou najbližších 90 dní.
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Nalepte nálepku

国际植入卡
TERUMO
Angio-Seal™ 血管闭合设备
设备类型：血管闭合设备
Angio-Seal™ 置入股动脉：□ 右 □ 左
吸收材料
请在接下来 90 天内随身携带此卡
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
粘贴贴纸

БЪЛГАРСКИ Имплантатная карта
TERUMO
Angio-Seal™ Васкуларно устройство за затваряне
Тип устройство: Васкуларно устройство за затваряне
Angio-Seal™ поставен във феморална артерия: □ Дясна □ Лява
Абсорбирани материали
Моля, носете тази карта със себе си през следващите 90 дни
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Поставяне на стикера

SLOVENŠČINA Kartica implantata
TERUMO
Sistem za zapiranje žil Angio-Seal™
Vrsta medicinskega pripomočka: Sistem za zapiranje žil
Angio-Seal™ vstavljen v femoralno arterijo: □ Desno □ Levo
Resorbirani materiali
To kartico imejte pri sebi naslednjih 90 dni
www.terumomedical.com/implantbrochure
MD Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device
Namestite nalepko

PRODUCT INFORMATION	DIE LINES	PRINTING COLORS	ART CHECKED BY	APPROVED BY
P/N: **ASIN0017** Customer: **Terumo Puerto Rico** Dimensions (inches): **W: 37.07** **H: 6.378**	CUT PERFORATION Die Lines will not print	Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black	THREE A PRESS Artist: John Figueroa Date: 06/19/2023 Customer Service E-mail alma@3apress.com	Customer: CJR Date: 28Jun2023 ☒ Art OK to print ☐ See Attached ☐ Another proof required Note: We must have a signed proof before we can begin production.

NOTE: THIS PROOF IS TO SHOW THE SIZE, COPY PLACEMENT AND COLOR BREAKS. ACTUAL COLORS WILL BE MATCHED ON PRESS WITH APPROVED COLOR STANDARDS AND/OR PANTONE COLOR SWATCHES.

Instruction for Completion

1. Name of the patient or patient ID. To be filled by the healthcare institution/provider.
2. Date of implantaton. To be filled by the healthcare institution/provider.
3. Name and address of the healthcare institution. To be filled by the healthcare institution/provider.
4. Select location where Angio-Seal device was implanted.
5. Place sticker from device packaging in "Place Sticker" location.

To the Angio-Seal™ Vascular Closure Device Patient

Please report to the doctor any bleeding, swelling, or bruising around the puncture site, or any discomfort experienced after the puncture is sealed. If you will need another puncture of the vessel in your groin within 90 days of this procedure, or if you experience any problems from this procedure, inform your doctor about your Angio-Seal device and show this patient information card. This information could affect your doctor's decision on how to proceed with your treatment. Please keep this card with you for the next 90 days.

To the Physician

This patient has received an Angio-Seal Vascular Closure Device. The device is resorbed within 90 days of placement. If repuncture at the same location of previous Angio-Seal device is necessary in 90 days, re-entry 1 cm proximal to the previous access site can be performed based on published medical literature*. Before considering Angio-Seal device use, a femoral angiogram of this site is indicated. The device has 3 absorbable components: an anchor deployed intra-arterially, small amount of collagen positioned on the outer wall of the artery and a suture trimmed below the skin. For additional information, please contact the physician noted on the reverse side. The product is not made with natural rubber latex. The implanted components of the device are MRI Safe.

*www.terumomedical.com/implantbrochure

Terumo Medical Corporation
265 Davidson Avenue, Suite 320
Somerset, NJ
08873 USA

Made in USA

EC REP Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven
Belgium

Terumo Medical Corporation
265 Davidson Avenue, Suite 320
Somerset, NJ
08873 USA
+1 732 302 4900
+1 800 283 7866

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven
Belgium
+32 16 38 12 11

Terumo China (Hong Kong) Ltd.
Room 607-608, 6/F
Harcourt House
39 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong
+852 2866 0811

Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd.
Part I, Floor 3, No. 56 Meisheng Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai, China
+86 21 6237 1155

Terumo Corporation
2-44-1 Hatagaya, Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
Japan
+81 3 3374 8111

Terumo Medical do Brasil Ltda.
Praça General Gentil Falcão
108 cj 91 e 92
04571-150 São Paulo – SP, Brasil
+55 11 3594 3800

Terumo Australia Pty Ltd.
Terumo Australia Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113
Australia

TERUMO
www.terumois.com

©2018 Terumo Medical Corporation. All rights reserved. All brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

MADE IN THE U.S.A.

2022-08-31
ASIN0017

PRODUCT INFORMATION	DIE LINES	PRINTING COLORS	ART CHECKED BY	APPROVED BY
P/N: **ASIN0017** Customer: **Terumo Puerto Rico** Dimensions (inches): **W: 37.07** **H: 6.378**	CUT PERFORATION Die Lines will not print	Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black	THREE A PRESS Artist: John Figueroa Date: 06/19/2023 Customer Service E-mail alma@3apress.com	Customer: CJR Date: 28Jun2023 [X] Art OK to print [ ] See Attached [ ] Another proof required Note: We must have a signed proof before we can begin production.

NOTE: THIS PROOF IS TO SHOW THE SIZE, COPY PLACEMENT AND COLOR BREAKS. ACTUAL COLORS WILL BE MATCHED ON PRESS WITH APPROVED COLOR STANDARDS AND/OR PANTONE COLOR SWATCHES.